

实验室服务先导

bóÉä~=mmp !"#

!

! !"

!"#\$%& !"

lêÖ~âáÅ=póáiÜÉëáóÉê=

`ÜÉääí~íáçâ

===mmpJNRNM ORNM

-10 150 !"#%&'()*+

!

15 !"# \$!"#%&'()*+, !"#%&' !"# \$



!"#\$%&'()

!"#\$%&'() !"# \$!"#%& !"#%&'()

!"#\$!" !"#%&'()*+,-./0!"#\$%&

!"#

!"#\$!"#%&'(!"#%&'()*+,-

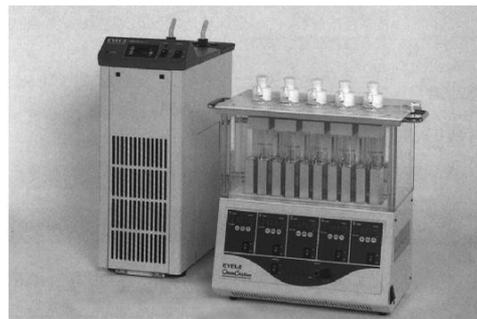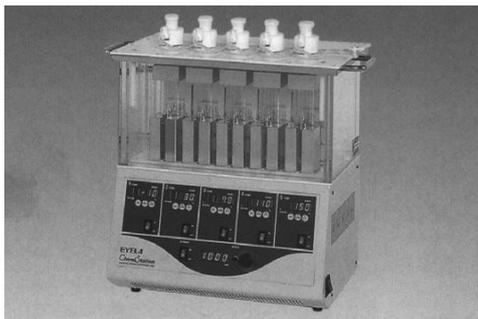

!"#\$%&

	mmpJNRNM	mmpJORNM
	198570	198580
!	1~4mL 5	10~30mL 5
!	!"#	
!"#	-50~150 (5!"#\$)*	
!"	0.5	
!"	200~1600rpm(4ml)	250~1300rpm(30ml)
	!"#\$	
!	+!"#	
!	!"#\$%&'()* !"#	
!	465W 310D 415H	465W 310D 465H
!"	10 5H ()	20 7H ()
	AC100V 50/60Hz 9A,900VA	

!"#\$!%&'#()!+,-./ !"#%&'()