


我司在北京师范大学顺利完成美国 ARS 公司 LT3 液氮/液氮型低温恒温器验收工作

近日我司在北京师范大学顺利完成美国 ARS 公司（ADVANCED RESEARCH SYSTEMS）LT3 液氮/液氮型低温恒温器验收工作，搭配布鲁克 Bruker VERTEX 80V 光谱仪；该款恒温器采用同轴液氮冷却低温传输管线，液氮消耗率同类产品最低 0.7LL/hr@4.2K.降温时间只有 20 分钟。

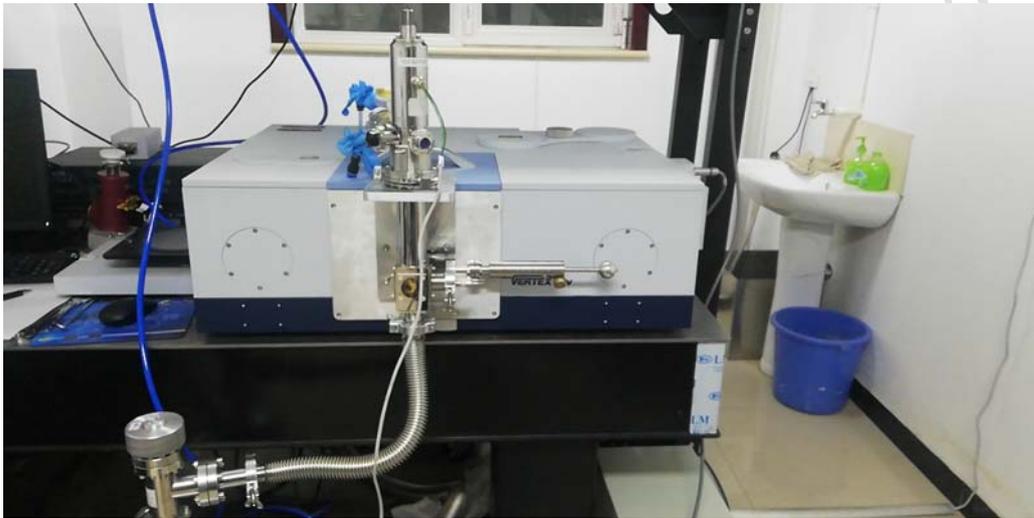

产品网站链接: <https://www.dowelllab.com/productinfo/1079728.html>