

荧光激发块转盘

IX3-RFAC-M



原装兼容

多达 8 个孔位

精确定位




齿纹转轮

夜光标识

快捷拆装

荧光激发块转盘 IX3-RFAC-M

IX3-RFAC-M 荧光激发块转盘是专为 OLYMPUS IX53/IX73/83 倒置显微镜量身设计开发，精确适配机身，激发块通用，配置 LED 荧光光源和荧光照明器组成平替的荧光附件，具有安装简单、成本低和效果佳特点，是荧光观察的优选配置。

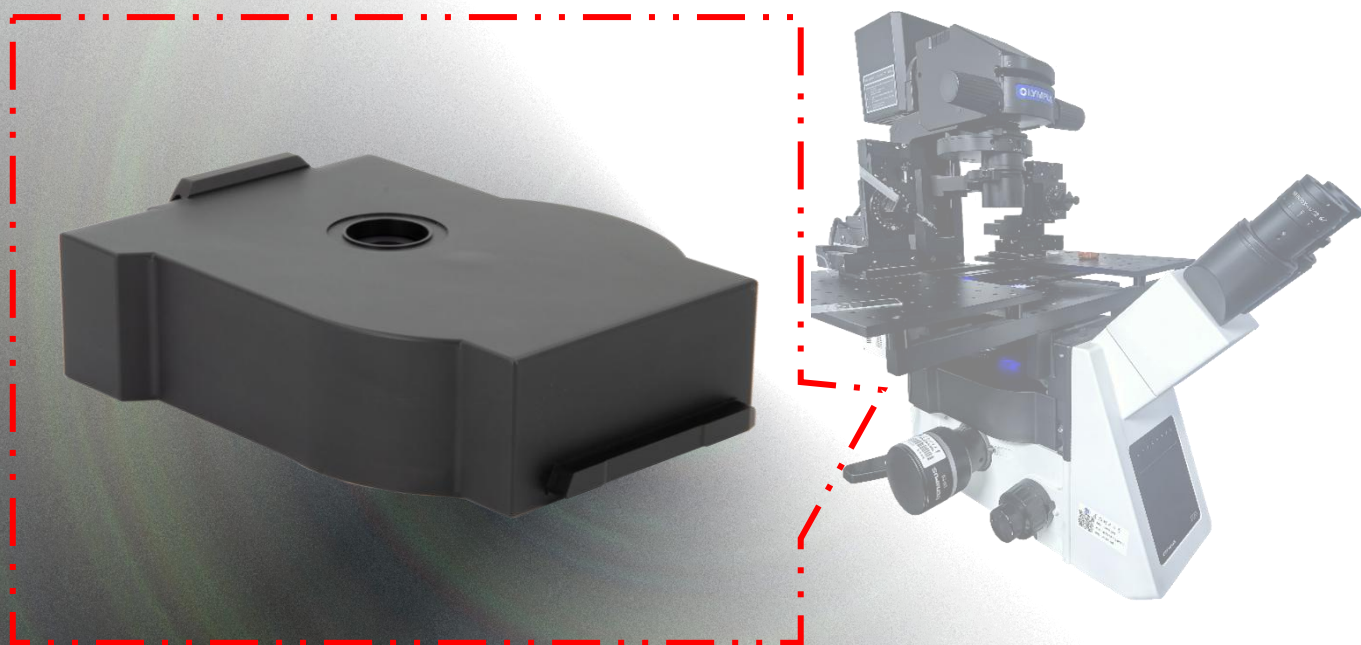

可配 UV (DAPI)、B (FITC)、G (TRITC)、Y (mCherry)、R (Cy5) 等荧光激发块，广泛应用于生物工程、生物医学、生物制药、医学检测和疾病预防等领域的荧光探针实验检测。

产 品 细 节

product details

01

无 缝 适 配



IX3-RFAC-M 荧光激发块转盘精准
测量重新设计，加工精细，精确
适配 IX53/73/83 机架。

02

精 准 定 位

精准定位弹珠，定位反馈清晰。

孔位标识 45 度倾斜且带夜光功能，

粗齿纹转轮，辅助进行精准定位。



03

产 品 细 节

product details

03

快 捷 拆 装



手扭螺丝固定侧窗，大开窗口，激发块弹珠压力固定，方便快捷更换。
方便多种荧光探针类型应用场景。

04

灵 活 通 用

荧光激发块安装多达 8 孔位，荧光探针类型应用广泛。
孔位与主厂荧光激发块通用。




04

配置组合

Combination & Matching

01

长效光源

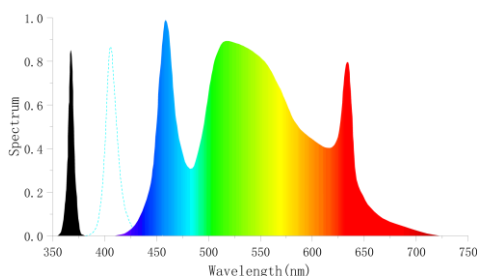

搭配独立长寿命 LED 荧光光源，
具有高功率，宽光谱，均匀输出，
荧光探针类型覆盖广泛。

02

均匀准直

搭配 IX3-RFA-C 荧光照明器，
光束有效均匀准直，效果佳。



05

产 品 参 数

Product Parameter

名称	规格
类型	倒置落射式
安装	原位嵌入固定
孔数	8 孔
激发块	原生尺寸，主厂通用、快拆式安装
转换	手动
标识	夜光
荧光镜组	UV 激发块 DAPI：激发 360/45nm；发射 460/50nm
	B 激发块 GFP：激发 470/35nm；发射 525/45nm
	G 激发块 TRITC：激发 540/35nm；发射 605/65nm
	Y 激发块 mCherry：激发 570/43nm；发射 630/40nm
	更多荧光探针匹配的荧光镜组，请联系我们咨询
荧光光源	LED 光源，寿命 ≥ 25000H
	宽光谱 350nm-700nm
	功率 85W
	0-100%线性光强调节
荧光照明器	直形照明器



业务热线：400-189-8960/ 18024548908

官网地址：www.lit-tech.com

业务邮箱：sales@lit-tech.com

公司地址：广州市南沙区市南大道 230 号



扫一扫，咨询我们