

# BT-9300Z 操作速览

## 1、仪器的摆放与连接



## 2、安装软件



摆放、连接与软件安装完毕。

# BT-9300Z 操作速览

## 3、系统调试与准确性标定

### 1 粒度仪分析系统控制菜单图解




### 2 调试与标定:




结论: 系统调试与标定已经完成, 一切正常可以使用。

# BT-9300Z 操作速览

## 4、清洗

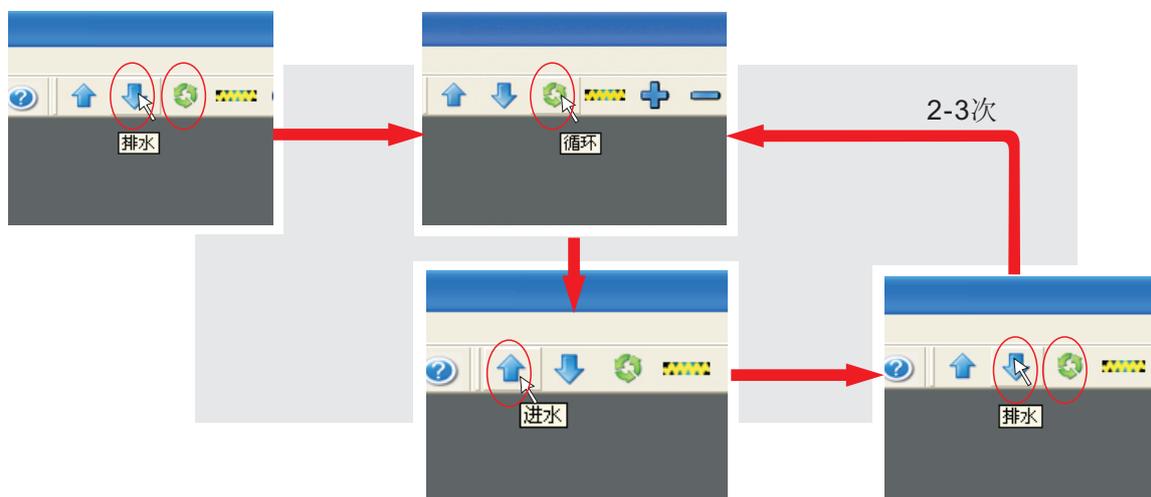

## 5、测试

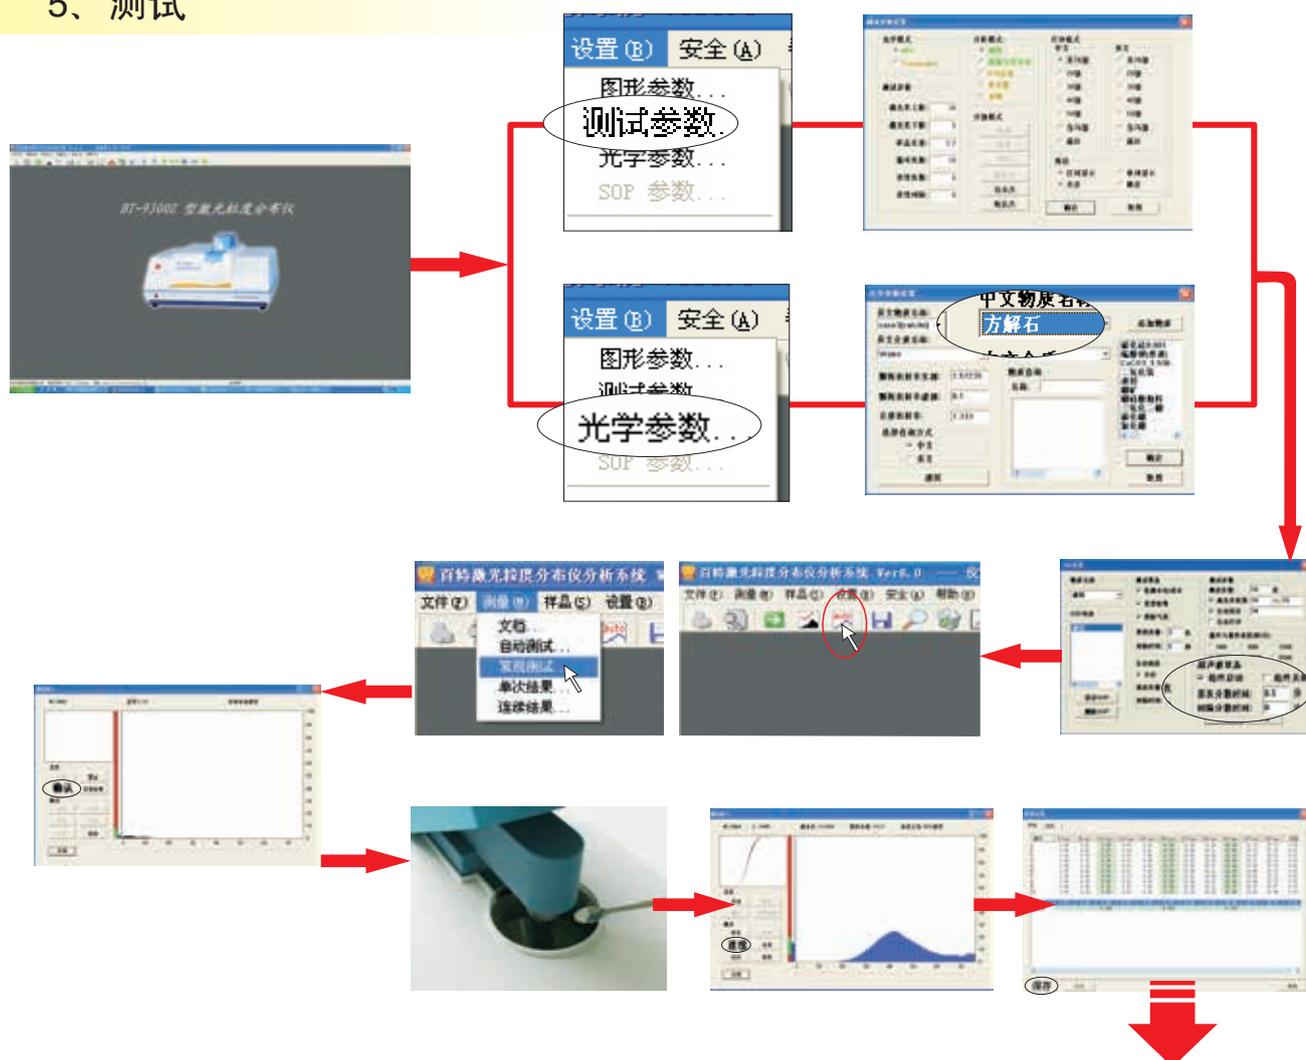

系统运行正常。